



# いきいき・新聞

（第二十二号）

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年は開院からの経営理念を見直し、左記の新たな理念を作成しました。そして現在この理念に基づいたクリニックの運営に努めております。まだまだ至らない点もありますが職員一同理念の追求を目指して参りますのでよろしくお願いいたします。また今年が開院十周年の節目の年にあたります。良き節目となるように皆様に喜んでいただけるような事業を検討したいと思います。楽しみにしててください。

院長 横木 広幸

## いきいき。クリニック経営理念

私たちは、『いきいき。クリニックに通院することは楽しみだ』といわれるクリニックを目指します。

私たちは、達成感を共有できる、働きやすいクリニックを目指します。

私たちは、ひとりひとりが他者を思いやることができる、優しさのあるクリニックを目指します。

私たちは、高い技術を持って、信頼されるクリニックを目指します。

私たちは、地域の方々のいきいきとした生活に、貢献するクリニックを目指します。

皆さんへお願いです！

感染性胃腸炎（ノロウイルス）、  
インフルエンザの流行時期に  
なりました。



**発熱、おう吐、吐き気はありませんか？**

急な発熱（38度以上）、嘔吐、  
下痢症状があれば必ずクリニックに電話をしてください。来院時  
間を変更して頂く場合がございます。  
また、体の具合が悪いと感じる場合には必ず透析室に入る前にスタップまでお申し出ください。

## 透析室での電気通信機器（携帯電話等）の使用について





平成二十九年十月二十六日に松江テルサで行われた「電波の安全性に関する説明会」医療機関において安心・安全に電波を利用するために「」に参加しました。

現在、多くの患者さんが電気通信機器（スマートフォン、タブレット等）を所持され、「ご家族・ご友人・仕事関係への連絡、写真・動画撮影、調べもの、動画の閲覧等に使用されているかと思えます。」自宅で使用される場合には特段の問題は無いかもしれませんが、医療機関で使用する場合、特に透析室で使用する場合はすぐ近くに医療機器の透析装置等があり、通信機器からの電波・送信電力により問題が起こる恐れがあります。東大病院での調査では、透析装置から携帯電話までの距離が8センチで『スピーカーからの異音』『異常表示と警告音の発生と運転停止』、透析装置から携帯電話までの距離が2センチで『警報の発生無く、設定値が自動で変更になる』ことが報告されています。透析室でのマナー向上も含め、透析室では次のルールを厳守して頂く様お願い申し上げます。

- ① 携帯電話はマナーモードに設定してください。
- ② 通話は周りの患者さんへの迷惑となりますので「遠慮ください」。
- ③ 透析中に携帯電話を使用（通話以外）される場合は必ず透析装置から30〜40センチ離してご使用ください。
- ④ 絶対に医療機器（透析装置等）の上に携帯電話を置かないでください。

今後も安心・安全な医療を提供していくために、「ご協力よろしくお願いたします」。


よろしく  
お願いたします

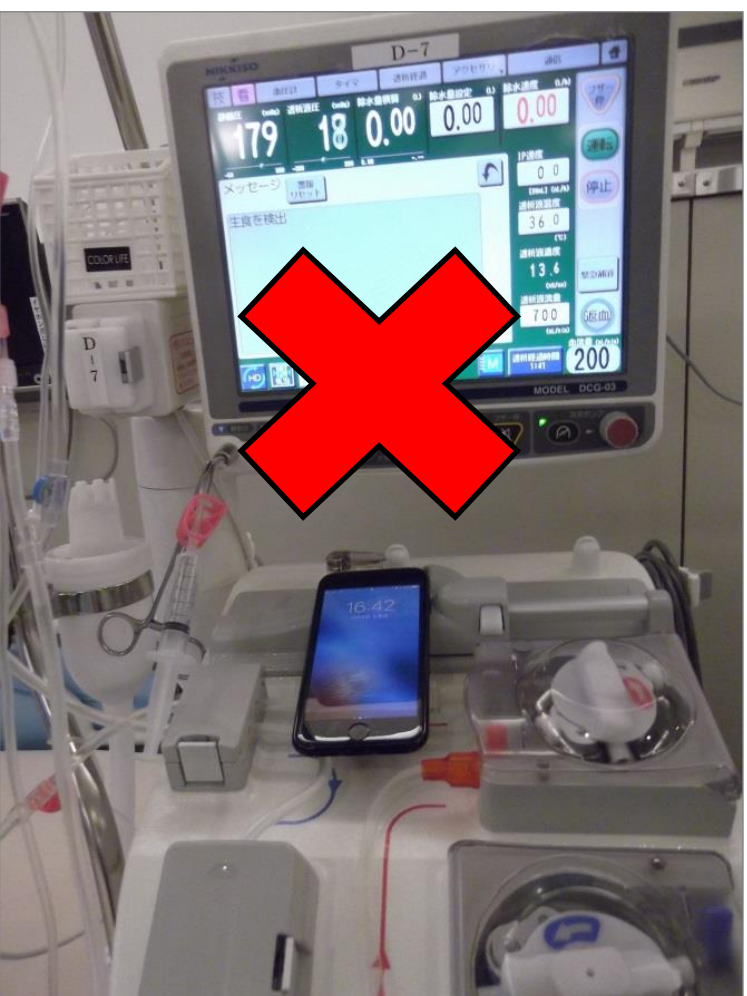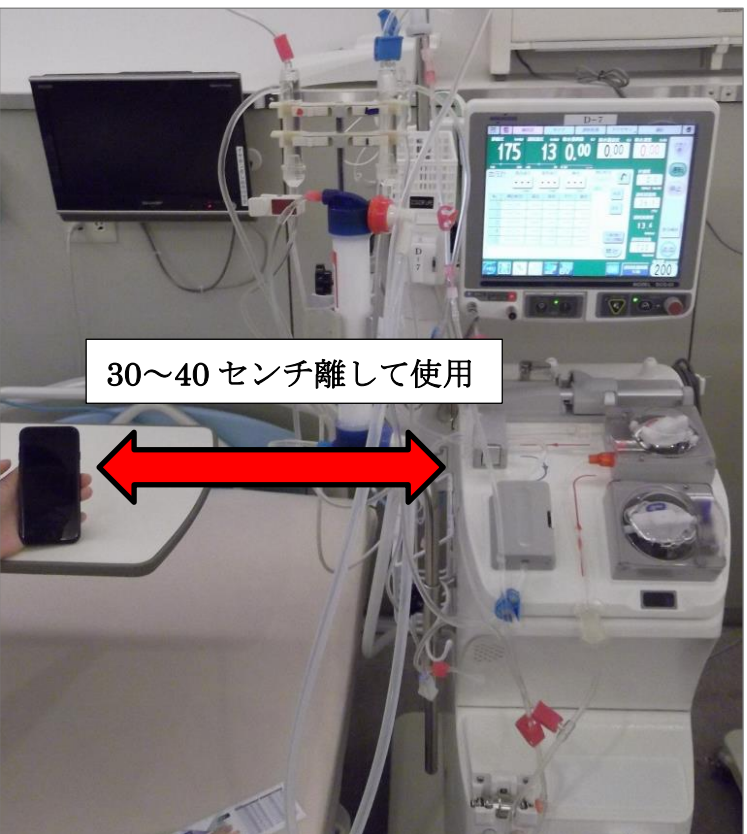

平成三十年一月三日 発行


編集

今年もよろしく  
お願いします

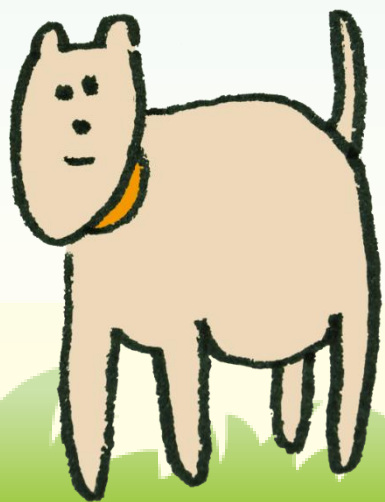

私達スタッフも勉強してきました！今回が初の参加でしたが、透析治療に携わる方がこんなにもおられるのかと、とても驚きました。(K)

○講演風景 (I)

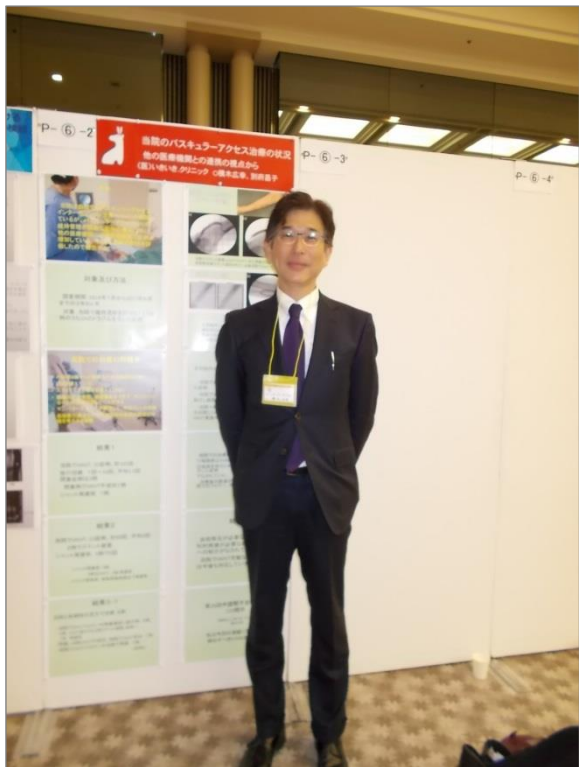

○ポスター発表者 (院長・T)

平成二十九年十一月、広島市にて第二十六回中国腎不全研究会が開催されました。当院は二題のポスター発表と一題の講演を行いました。

